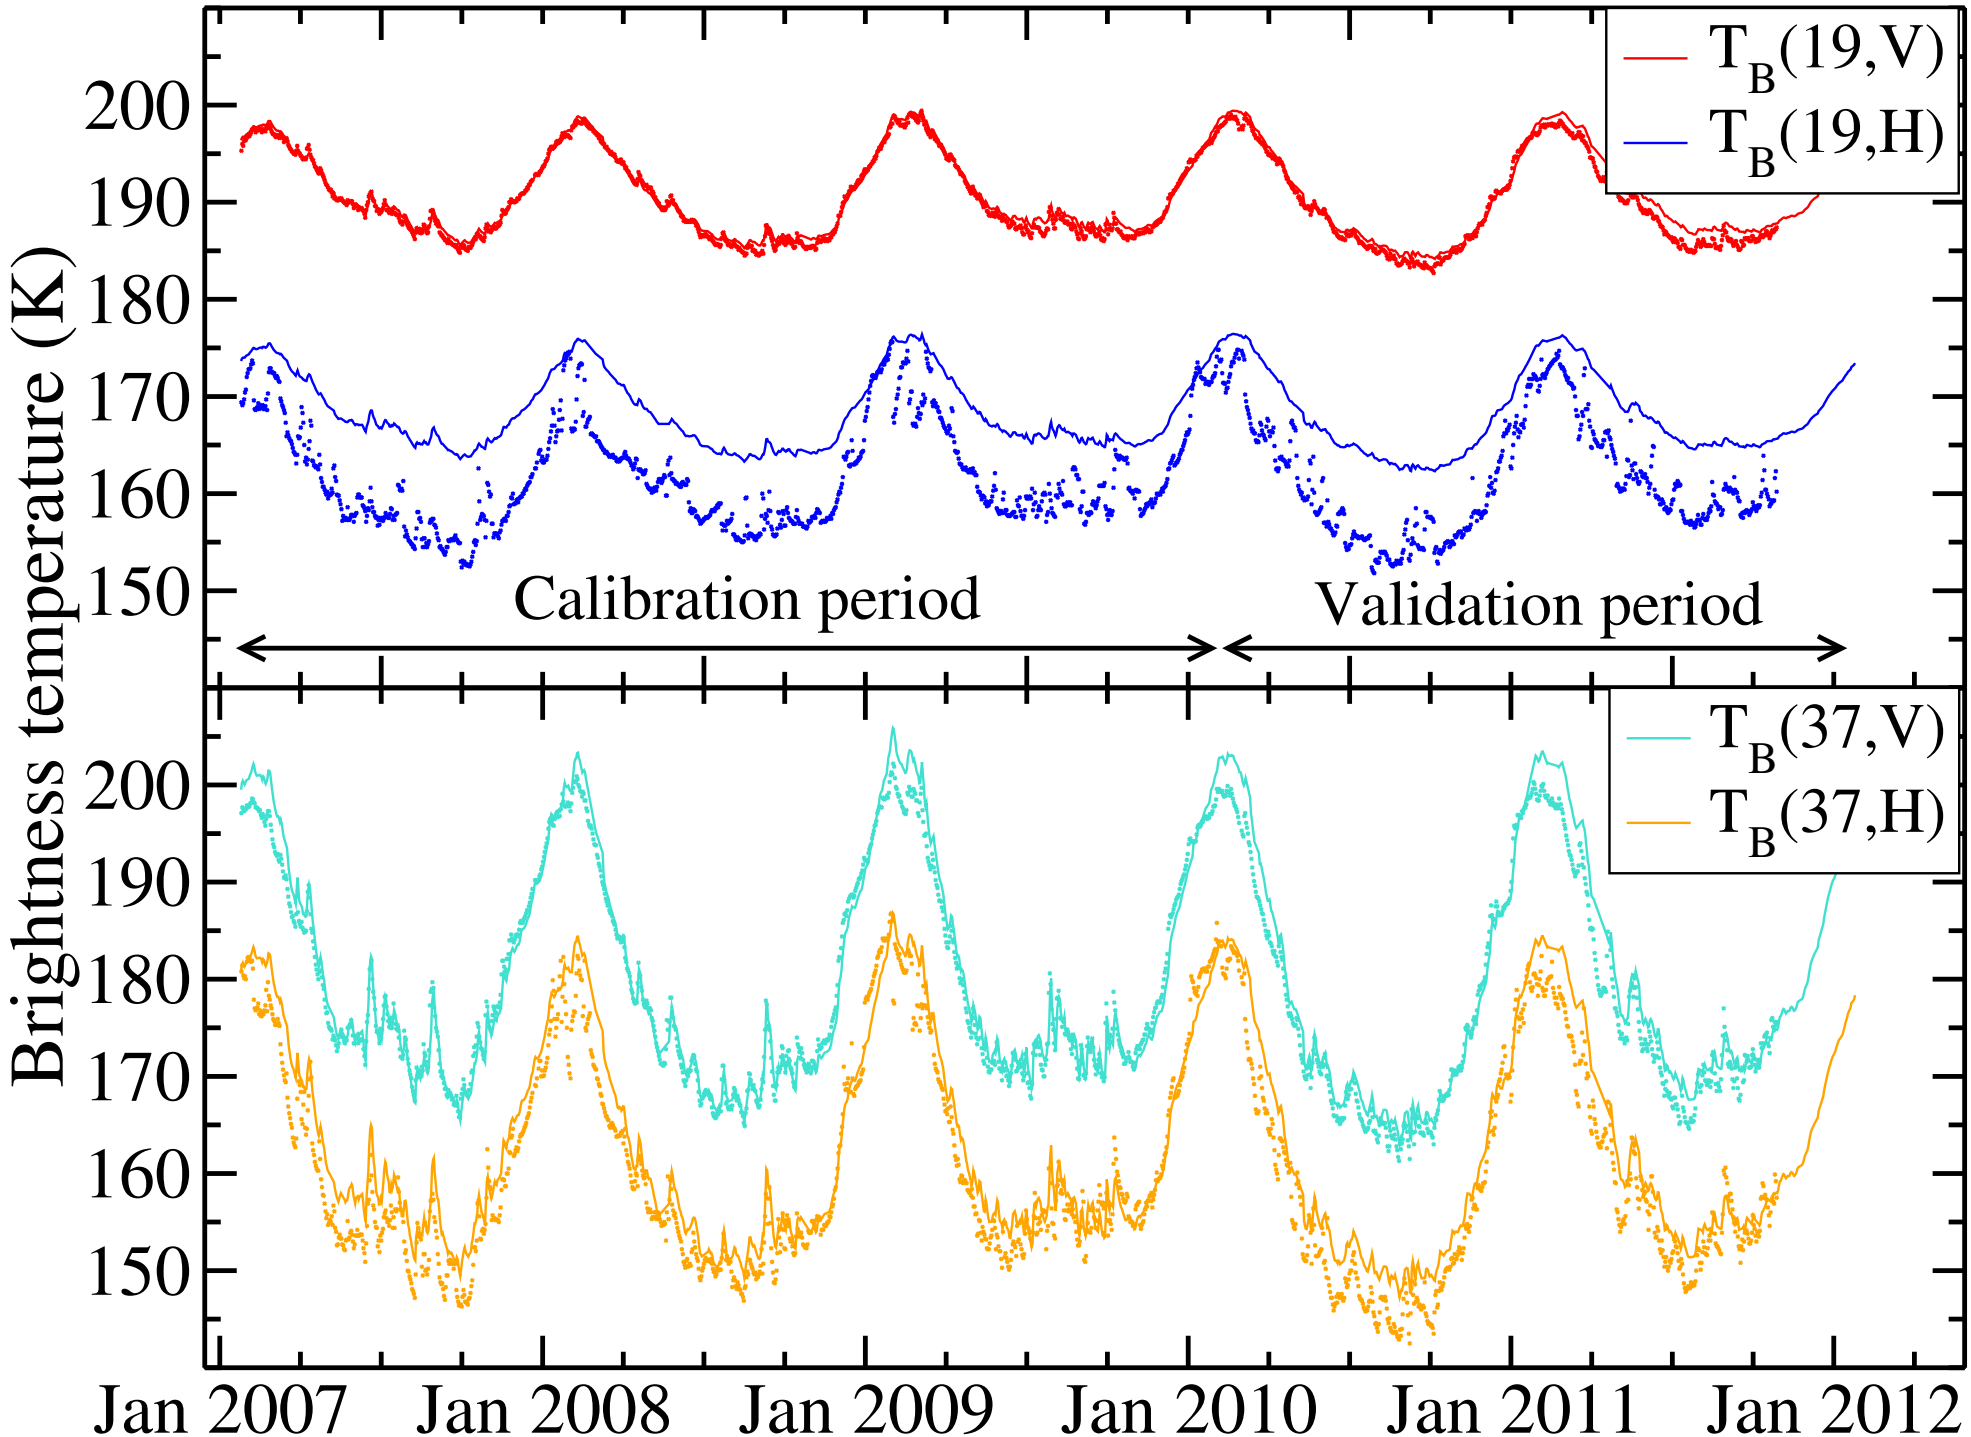
Brightness temperature (K)
200
190
180
170
160
150
$T_B(19,V)$
$T_B(19,H)$
Calibration period
Validation period
$T_B(37,V)$
$T_B(37,H)$
Jan 2007
Jan 2008
Jan 2009
Jan 2010
Jan 2011
Jan 2012